

検体測定室 第 10 回脂質 外部精度管理調査報告書

検体測定室連携協議会

1. 実施の概要

1) 主催

検体測定室連携協議会

2) 試料の調製、発送および報告値の解析

一般社団法人 検査医学標準物質機構 (ReCCS)

3) 調査項目

総コレステロール、中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール 4 項目

4) 実施スケジュール

参加申込: 2026 年 4 月 16 日～5 月 13 日

試料配布(発送): 2026 年 5 月 26 日

測定結果報告の締切: 2026 年 6 月 5 日

5) 参加費

検体測定室連携協議会 正会員 15,000 円、非会員 25,000 円

6) 試料の性状

試料の性状: ヒト血清(液状凍結品)

試料本数および容量: 1 本(0.3 mL)

7) 目標値の測定機関

測定機器メーカー

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

8) 測定および報告方法

参加施設で使用している脂質測定装置を用いて、試料到着の当日あるいは翌日のいずれかの実施とし、測定回数は各 2 回とした。測定結果の報告は、検体測定室連携協議会ホームページの特設ページにて参加施設側が入力した。

9) 報告値の解析および評価指標

解析に使用した各施設の測定値は 2 回の測定値の平均値をそれぞれ用いた。評価指標には、各施設の測定平均値の目標値に対する相対バイアス(%)を用いた。なお、相対バイアスの評価基準は、測定機器の性能規格を参照して±15 %以内とした。

2. 結果

1) 参加数

表 1 に測定装置別の参加数を示す。参加施設の総数は 24 施設であった。2回測定のうち 1 回分の報告があった施設は、その値を採用して評価施設に含めた。

表 1 測定装置別参加数

測定装置	装置 A	装置 B	合計
参加数	9	15	24

2) 試料の性状

表 2 に試料の一般性状を示す。試料にはヒト血清(凍結品)を用いた。

表 2 試料の性状

総蛋白: 7.3 g/dL	リポ蛋白分画	α -LP: 41.5 %
アルブミン: 3.9 g/dL		pre β -LP: 7.1 %
尿酸: 4.3 mg/dL		β -LP: 41.2 %
総ビリルビン: 0.3 mg/dL		origin: 10.2 %

3) 目標値の設定

表 3 に試料の目標値を示す。測定機器メーカーのラボにて測定した平均値を目標値とした。

表 3 試料の目標値

測定項目	濃度 (mg/dL)
総コレステロール	139.0
中性脂肪	73.3
HDL-コレステロール	53.9
LDL-コレステロール	70.3

4) 測定値の解析

測定値の解析結果を表 4 に示す。項目ごとに、評価施設数、目標値(機器メーカー測定値)、平均値(参加施設平均)、最小値、最大値、SD(参加施設標準偏差)、CV(参加施設変動係数, %)、評価基準を満たした施設数および評価基準を満たさなかった施設数をそれぞれ求めた。

表 5 には装置ごと評価施設数と平均値を示す。

表 4 測定値の解析結果

測定項目	総コレステロール	中性脂肪	HDL-C	LDL-C
評価施設数	24	24	24	24
目標値 (mg/dL)	139.0	73.3	53.9	70.3
平均値 (mg/dL)	141.9	73.1	52.2	75.1
MIN (mg/dL)	129.5	62.0	48.5	68.5
MAX (mg/dL)	152.0	82.5	56.0	83.0
SD	4.5	4.5	2.6	3.8
CV(%)	3.2%	6.1%	5.0%	5.0%
評価基準を満たした施設数	24	23	24	22
評価基準を満たさなかった施設数	0	1	0	2

表 5 装置別測定値

測定項目	総コレステロール		中性脂肪		HDL-C		LDL-C	
測定装置	装置 A	装置 B	装置 A	装置 B	装置 A	装置 B	装置 A	装置 B
評価施設数	9	15	9	15	9	15	9	15
平均値 (mg/dL)	143.3	141.1	75.4	71.8	51.3	52.7	76.7	74.1

5) 結果の評価

① 評価方法

測定値の目標値に対する相対バイアス(%)を算出し、評価基準(±15 %以内)と比較した。

② 施設測定値の分布

図1に項目毎の測定値分布を示す。①で示す評価基準(±15 %)を破線で示した。

評価基準を満たした施設の割合は、全 24 施設中、総コレステロール、HDL コレステロールが 24 施設 (100%)、中性脂肪が 23 施設(96%)、LDL コレステロールが 22 施設 (92 %)であった。

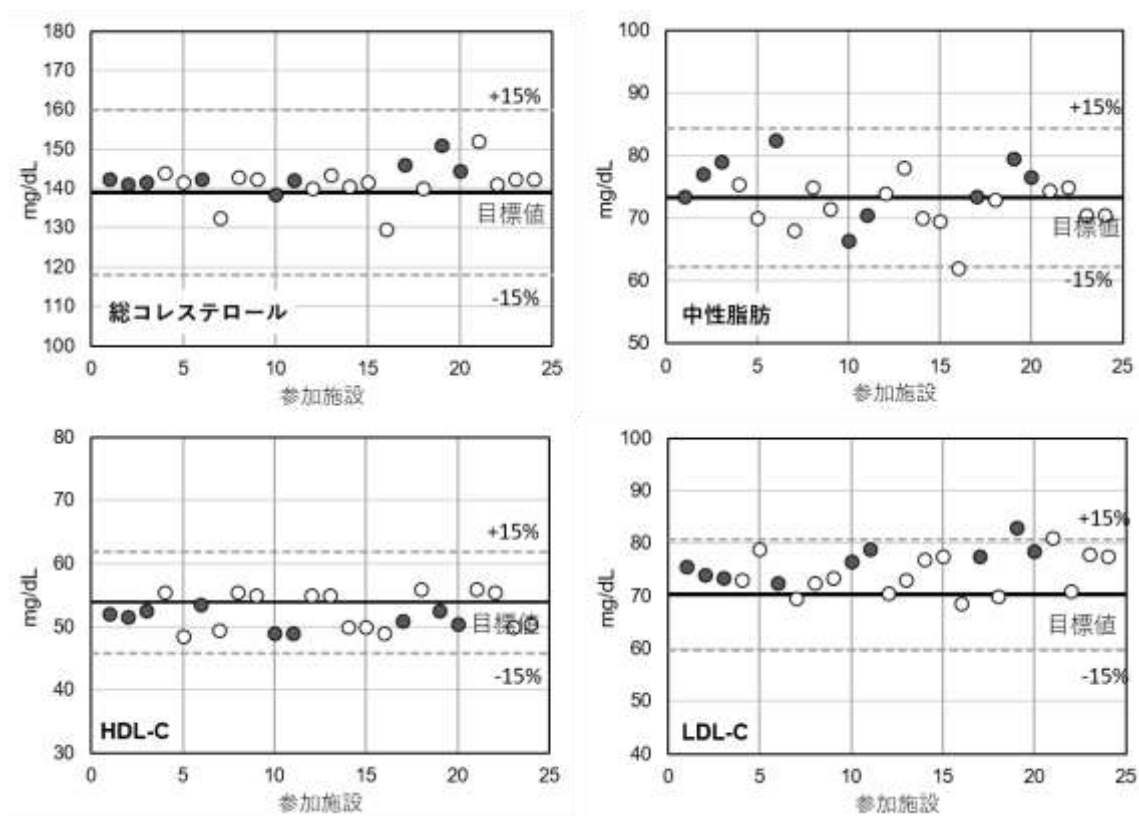


図1 測定値の分布 (装置 A: ● 装置 B:○)

3. 結論

評価施設の総数は 24 施設、測定装置は 2 機種であった。

全項目において、90%以上が評価基準を満たしており、良好な結果であった。

機器間差についても、測定のはらつきを鑑みれば有意ではなく、全体の収束性としては良好である。

評価基準を満たさなかった施設、測定時にエラーを示した施設においては、測定手順を確認・遵守し、当該測定装置メーカーの協力を得るなどして引き続き測定の信頼性を確保することが必要である。

4. 参考

これまでの本調査結果の推移を表 6 に示す。

表 6 検体測定室 脂質 外部精度管理調査 結果の推移

測定項目		総コレステロール、中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール								
試験試料		凍結血清								
目標値の設定法		機器メーカー 平均値								
評価基準		目標値に対する相対バイアス(%) ±15 %以内								
回	実施年月	参加 施設	機種 数	未提出 施設	評価 施設	評価基準を満たした施設				
						総コレステロール	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	
1	2021 年 11 月	154	2	5	149	149 (100 %)	147 (99 %)	146 (98 %)	148 (99 %)	
2	2022 年 5 月	72	2	3	69	69 (100 %)	68 (99 %)	68 (99 %)	67 (97 %)	
3	2022 年 11 月	139	2	15	124	124 (100 %)	123 (99 %)	121 (98 %)	122 (98 %)	
4	2023 年 5 月	76	2	1	75	75 (100 %)	74 (99 %)	75 (100 %)	73 (97 %)	
5	2023 年 11 月	144	2	14	130	128 (98 %)	128 (98 %)	126 (97 %)	125 (96 %)	
6	2024 年 5 月	56	2	3	53	52 (98 %)	53 (100 %)	41 (77 %)	53 (100 %)	
7	2024 年 11 月	121	2	20	101	100 (99 %)	100 (99 %)	98 (97 %)	94 (93 %)	
8	2025 年 5 月	54	2	0	54	54 (100 %)	54 (100 %)	54 (100 %)	53 (98 %)	
9	2025 年 11 月	125	2	9	116	116 (100 %)	116 (100 %)	116 (100 %)	102 (88 %)	
10	2026 年 5 月	24	2	0	24	24 (100 %)	23 (96 %)	24 (100 %)	22 (92 %)	

以上